



表

包装内容

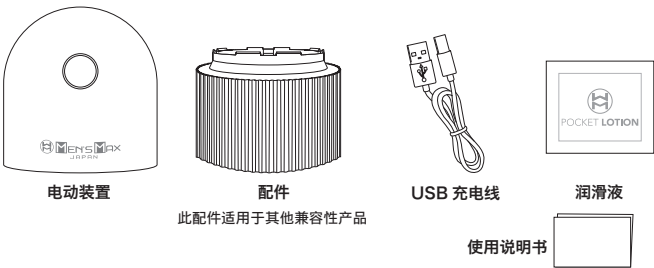


各部位名称及基本操作

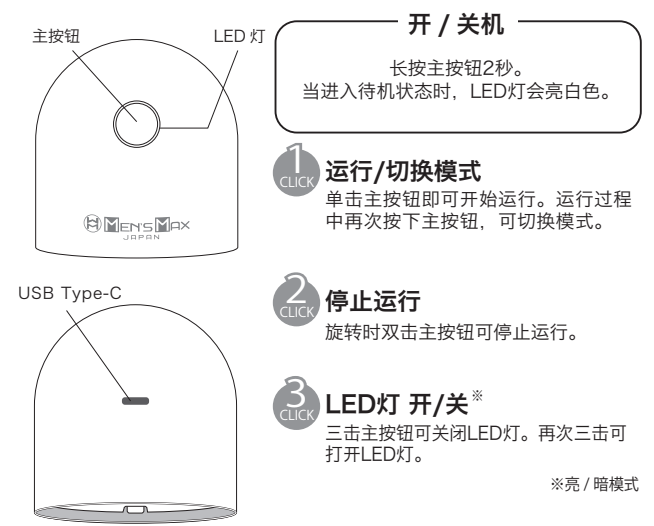

裏


拆卸方法

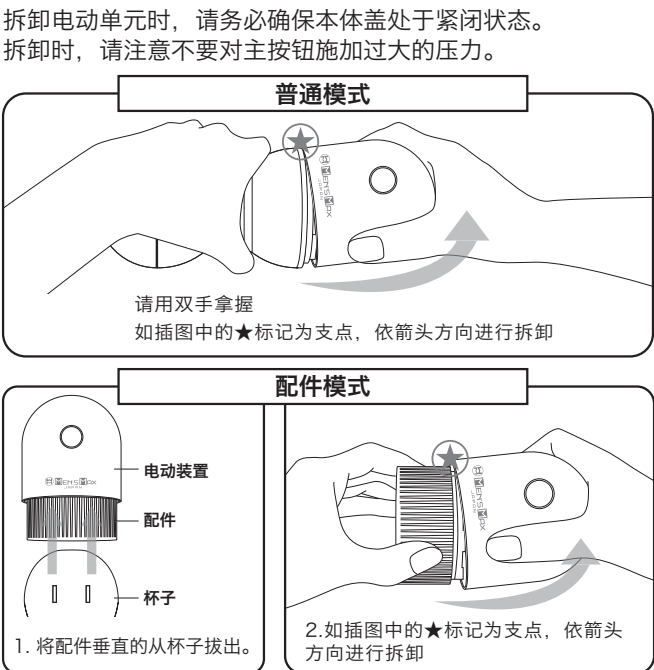

品名	G-GLIDE/ MM-82-000
工作时间	约 200 分
充电时间	电脑或 AC 适配器: 300 分钟 支持快速充电的 AC 适配器: 240 分钟
外观尺寸/重量	长 8.7cm × 宽 8.7cm × 高 9cm / 重 256g USB 线... 长 50cm / 重 9g
电子零件与材质	PC、ABS/PCBA、马达、锂电池 (800mAh)


切换模式

运行过程中点击主按钮，可切换9种不同的旋转模式。
※连续点击可能会导致无法顺利切换模式。

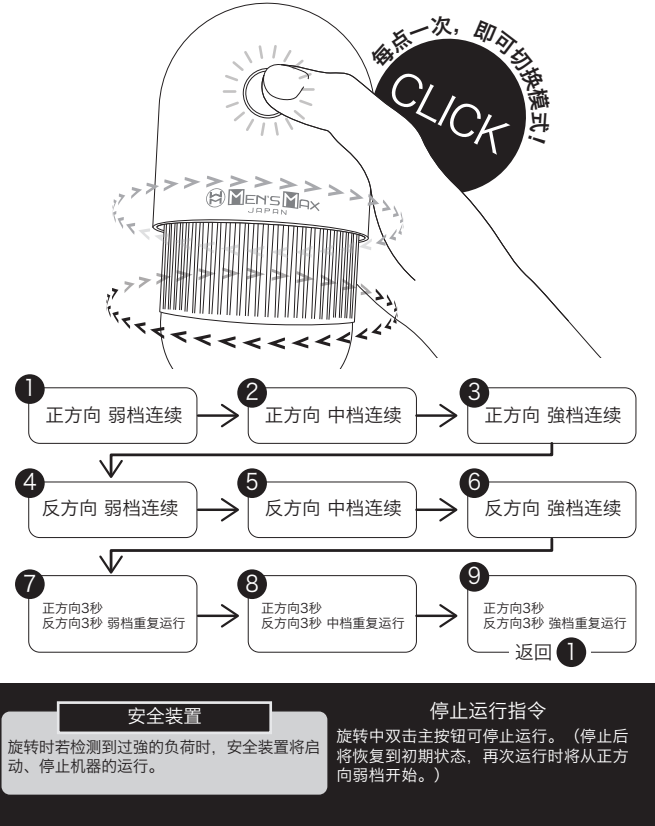


裏


充电方法

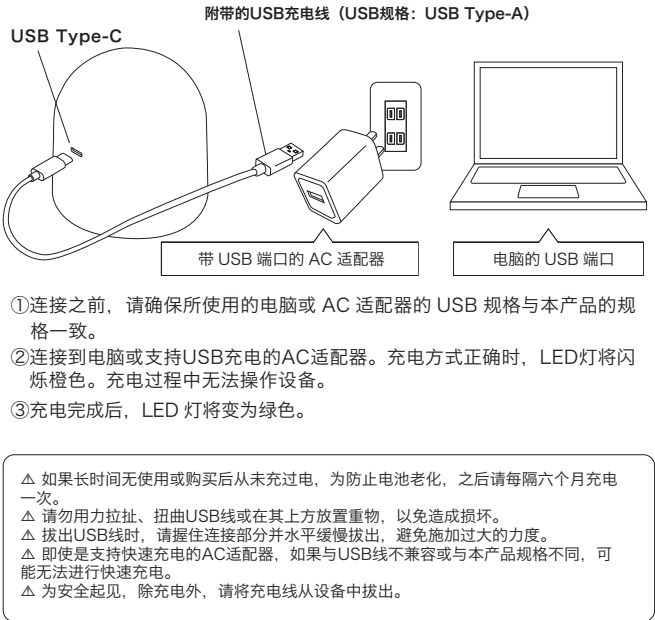


使用注意事
· 请注意，在内部干燥的状况下使用会降低使用感。长时间使用时，请准备润滑液，并在在使用过程中随时补充。
· 使用过程中请注意，避免衣物、毛发、手指等卷入杯子或本产品中。
· 如果感到疼痛或不适，请立即关闭电源并停止使用。继续使用可能会导致身体受伤。
· 本产品不具备防水功能。请勿在可能接触到水份的地方使用。
· 若产品被润滑油等弄脏时,请使用干布或湿巾擦拭。请勿用水清洗或浸泡主机,以免引起触电或故障。



安装方法（标准模式）适用于GRIT

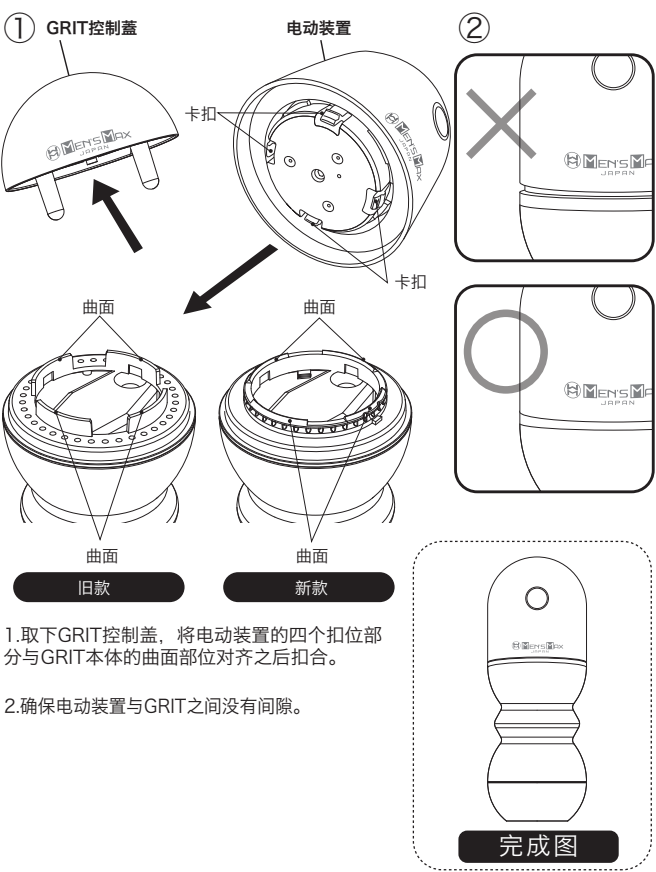

安装方法（配件模式）适用于其他兼容性产品

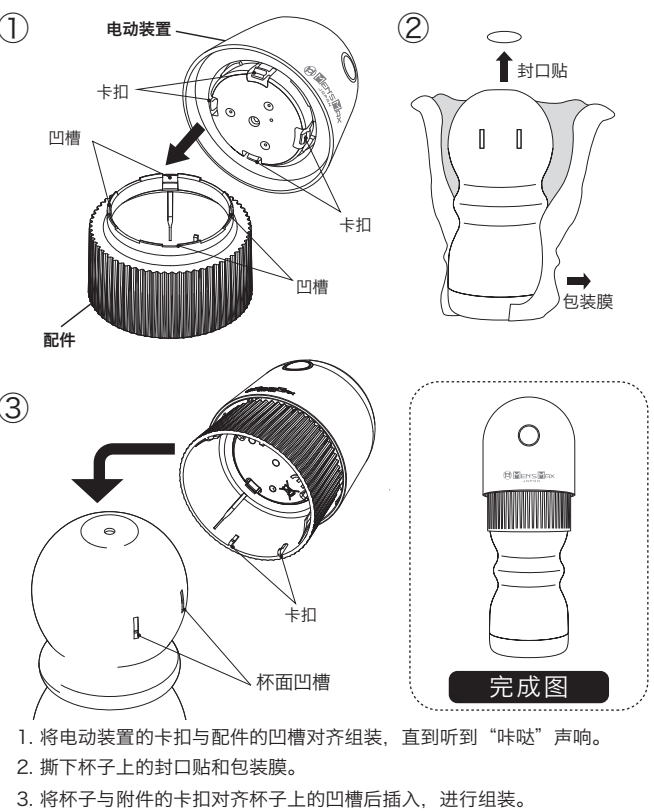

安全注意事项

- 为防止故障、发热或起火。请勿在阳光直射或高温的地方使用或存放本产品。
- 请勿在清洁时使用稀释剂、苯、酒精或热水，以免引起变色或变形。
- 请存放在幼儿无法接触的地方，以防触电、受伤或误食等事故。
- 请勿撞击、掉落、踩踏或在产品上放置重物，以免导致故障。
- 身体不适时请勿使用本产品。使用医疗电子设备（如心脏起搏器）的人士、孕妇及可能导致身体不适的人士请勿使用本产品。
- 使用过程中如感到身体不适，请立即停止使用并咨询医生。继续使用可能导致事故或健康问题。
- 请勿在饮酒中或饮酒后使用，以免引发事故或受伤。
- 使用后请务必关闭电源，以免引发事故或受伤。
- 产品充电时，请正确连接USB线。不正确的连接方式可能导致故障、发热或起火。
- 请勿在打开电源的情况下充电，可能导致故障、发热或起火。
- 请勿自行改造或将产品靠近热源，或在使用时吸烟，以免导致触电或火灾。
- 拔出USB线时，请抓住连接头部分拔出，避免施加过大的力度。
- 请勿自行改造或将产品靠近热源，或在使用时吸烟，以免导致触电或火灾。
- 充电时以外，请拔下USB线，以防止灰尘和湿气导致绝缘不良，产生漏电火灾的风险。
- 请定期清洁USB端子，防止灰尘积聚，导致绝缘不良，产生漏电火灾的风险。
- 本产品是男性健康护理设备。如用于其他目的、恕不负责。使用时请自行承担风险。
- 请勿自行拆解、维修或改装本产品，可能导致起火或异常操作，造成受伤。
- 请勿将水倒在产品上或将其弄湿。
- 请勿在有伤口、肿胀、炎症或皮疹的部位使用。
- 如感觉产品发出异常声音或运行异常，请立即停止使用并关闭电源。继续使用可能导致事故或受伤。
- 清洁时，请拔下USB线。请勿用湿的手插拔，以免触电或烫伤。
- 请勿在USB线损坏或USB端口和插座松动时使用，可能导致起火或触电。
- 请勿在旋转过程中直接用手抓住产品并向相反方向旋转，或用力按压，以免对电机造成负担，导致触电、短路或故障。
- 对于因不遵守本使用说明书所引起的损害，本公司概不负责。

初期不良品的更换
如果发现产品有初期缺陷，请在产品到达后的1个月内与我们联系，并告知详细情况。在通过产品的操作检查后确认缺陷时，我们将接受更换。请注意，通过网络拍卖、跳蚤市场或二手商店购买的产品将不在保修范围内。在产品售罄等情况下，有可能无法进行更换。敬请理解。

＜更换时所需物品＞
1. 产品（遗失、改造、拆解或废弃后的申请不予受理）
2. 购买证明（购物收据、网上购物网站的购买记录页面的打印件等）

